SmartInfuser™

Программируемое Механическое Регулирующее Дозирующее Устройство

A	**Первичная Установка Помпы** Выбор рабочих характеристик комплекта устройств

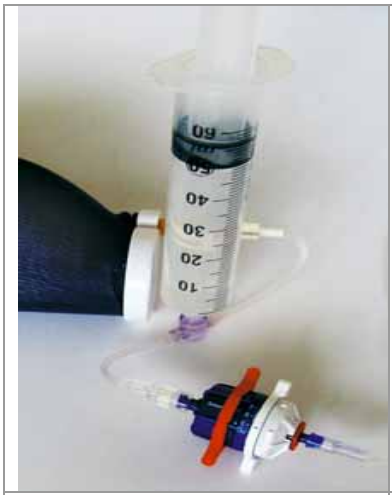	1	**Заполнение Помпы** • Заполнить любым количеством препарата от 50 до 500 мл • Установить Регулирующее Дозирующее Устройство SmartReg на C (Closed - Закрыто). • Снять пробку запорного клапана Компрессионного Блока • Используя шприц, прилагающийся в комплекте, заполнить резервуар Компрессионного Блока • Закрыть запорный клапан пробкой
	2	**Установка Ритма Введения** • Установить регулирующее кольцо на R (Regulation - Регулирование) • Выбрать необходимый ритм введения, установив стрелку регулирующего кольца на нужную отметку на шкале • Утопить регулирующее кольцо в корпус регулятора для фиксации выбранного ритма введения
	3	**Болюс** • Установить необходимый объем болюса путём установки стрелки на необходимой отметке на шкале

B	**Процесс Стационарного Лечения** Переустановка рабочих характеристик до полного соответствия изменяющемуся состоянию пациента

	1	**Пополнение Помпы** • Пополнить резервуар Компрессионного Блока любым количеством препарата от 50 до 500 мл. • Снять пробку запорного клапана Компрессионного Блока • Используя шприц, прилагающийся в комплекте, заполнить резервуар Компрессионного Блока • Закрыть запорный клапан пробкой
	2	**Корректировка Ритма Введения** • Вытянуть регулирующее кольцо из корпуса регулятора. • Выбрать необходимый ритм введения, установив стрелку регулирующего кольца на нужную отметку на шкале. • Утопить регулирующее кольцо в корпус регулятора для фиксации выбранного ритма введения
	3	**Болюс** • Установить необходимый объем болюса путём установки стрелки на необходимой отметке шкалы

C	**Амбулаторное Лечение** Перед выпиской пациента на амбулаторное лечение, зафиксировать установленные характеристики работы устройств во избежание несанкционированного вмешательства

	1	**Пополнение Помпы** • Пополнить резервуар Компрессионного Блока любым количеством препарата от 50 до 500 мл. • Снять пробку запорного клапана Компрессионного Блока • Используя шприц, прилагающийся в комплекте, заполнить резервуар Компрессионного Блока • Закрыть запорный клапан пробкой
	2	**Корректировка и Фиксация Ритма Введения** • Вытянуть регулирующее кольцо из корпуса регулятора. • Выбрать необходимый ритм введения, • Утопить регулирующее кольцо в корпус регулятора • Утопить красную муфту в корпус регулятора. Утопленная красная муфта блокирует устройство и дальнейшие изменения рабочих характеристик регулятора невозможны.
	3	**Болюс** • Установить необходимый объем болюса для амбулаторного лечения и утопить предохранитель болюса

Продолжительность процедуры (дни)	Ритм Введения (мл/ч)	Требуемый Объем Раствора (мл)
2	1	50
2	2	100
2	3	150
2	4	200
2	5	250
2	6	300
3	1	75
3	2	150
3	3	225
3	4	300
3	5	375
3	6	450
4	1	100
4	2	200
4	3	300
4	4	400
4	5	500
5	1	125
5	2	250
5	3	375
5	4	500
6	1	150
6	2	300
6	3	450
7	1	175
7	2	350

ООО «КОРАЛЛ-ЭСТ»
129226, Москва,
ул. Докукина, д.8, стр.2, оф.318,
Т/ф.: (495)640-49-92, 640-49-93
E-mail: admin@korallest.ru
http://www.korallesr.ru